

HUAZHENG TEST

7-87968590

华止恒
HUAZHENG TEST

8590

22
04
05

武

环 金

委 20

仙桃

绿

面
委
检
报

(检

告

WU
Call

卷一

卷二

卷三

卷四

卷五

卷六

卷七

卷八

卷九

卷十

卷十一

卷十二

卷十三

卷十四

卷十五



华正
HUAZHENG

一、任

受仙
4月8日
并于202

二、企


垃圾
及焚烧
辅
助净化

三、监

监测类
废气在
北对监测

四、样

类别
气

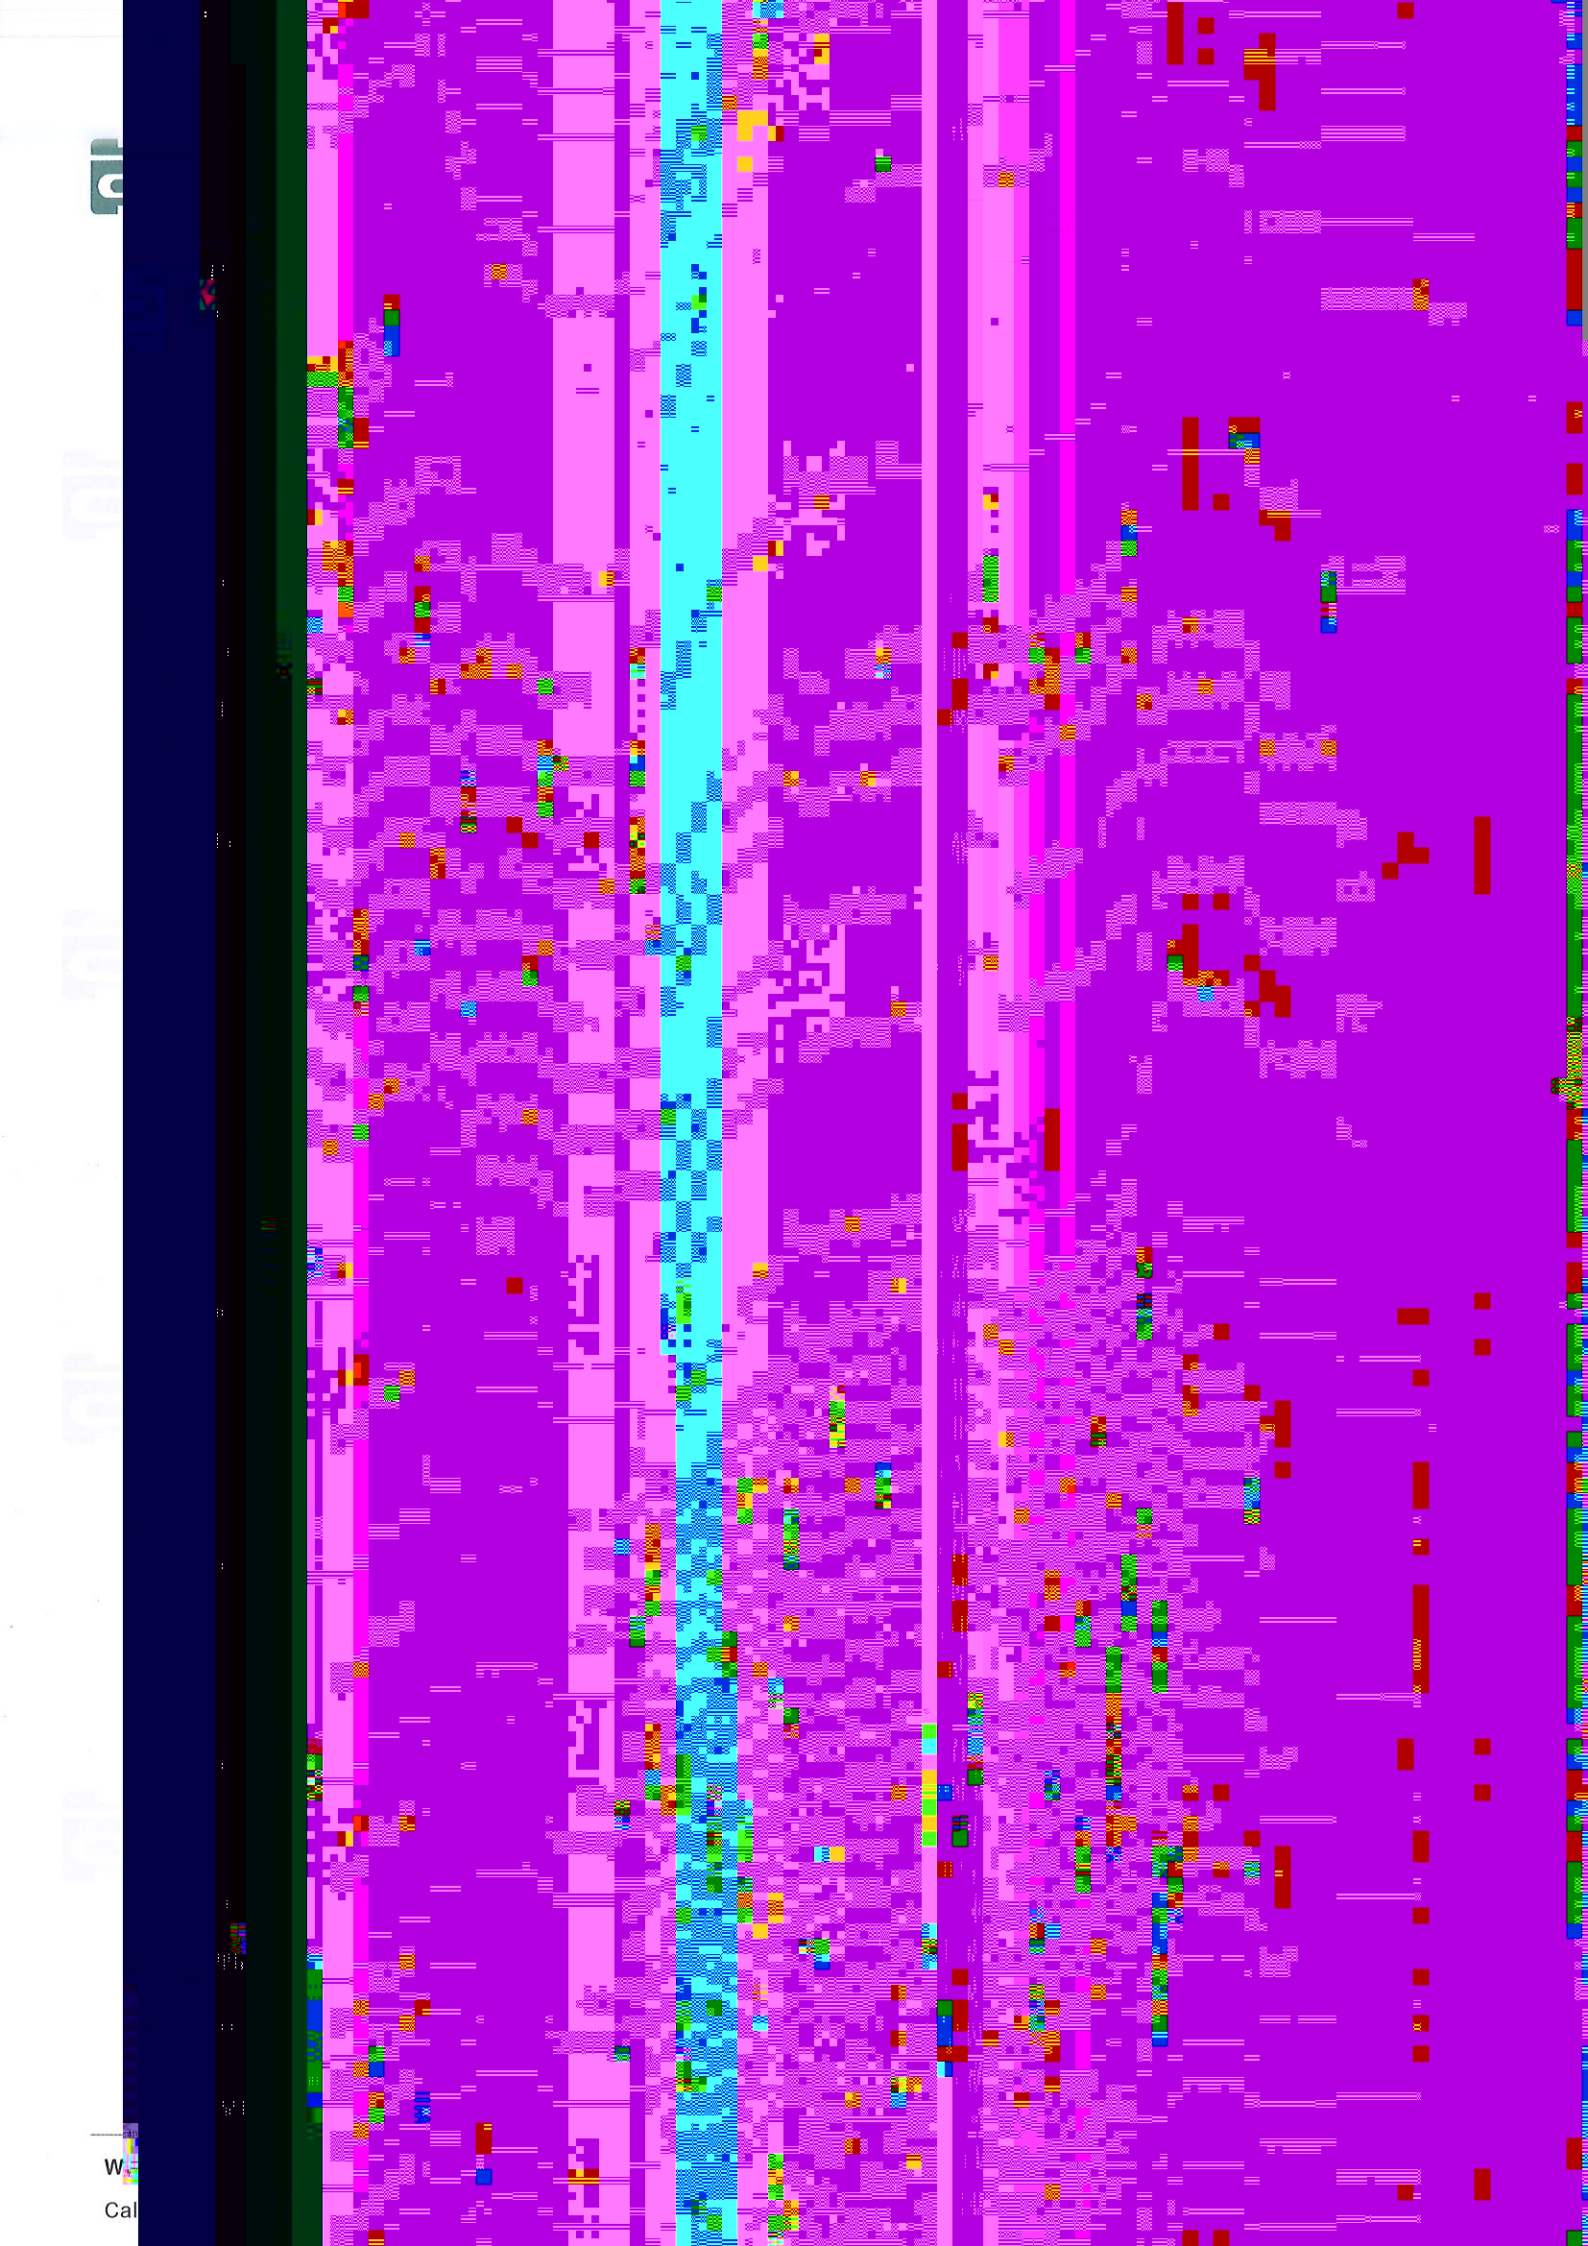

华
HUA2

号)
术要

报告编号: 武

氯化氢自动监测设
生活垃圾焚烧发电厂

表 2

非放	浓度比	g值
≥250	μmol/m	
≥50	μmol/l	no
≤25	ng/m ³	)
≥20	μmol/l	no
≥20	μmol/l	no
放	浓度比	g值
≥250	μmol/m	
≥50	μmol/l	ol
≥50	μmol/m	ol

氣云

精度\



1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0



华正
HUAZHEN

1-2、

监测点

DA002
气筒 (C)

比对监测
结果

DA003
气筒 (C)

比对监测
结果

testing.com

11 页

法

2、

监

DA

排

(C

比

结

DA0

排

(C

比

结

备注



华正
HUAZHENG
ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO., LTD.

4、污染源

监测点

DAC002(2#)
筒)(◎1)

对比监测


样品类型

监测点

DAC003(1#)
筒)(◎2)

对比监测

备注: ND 表

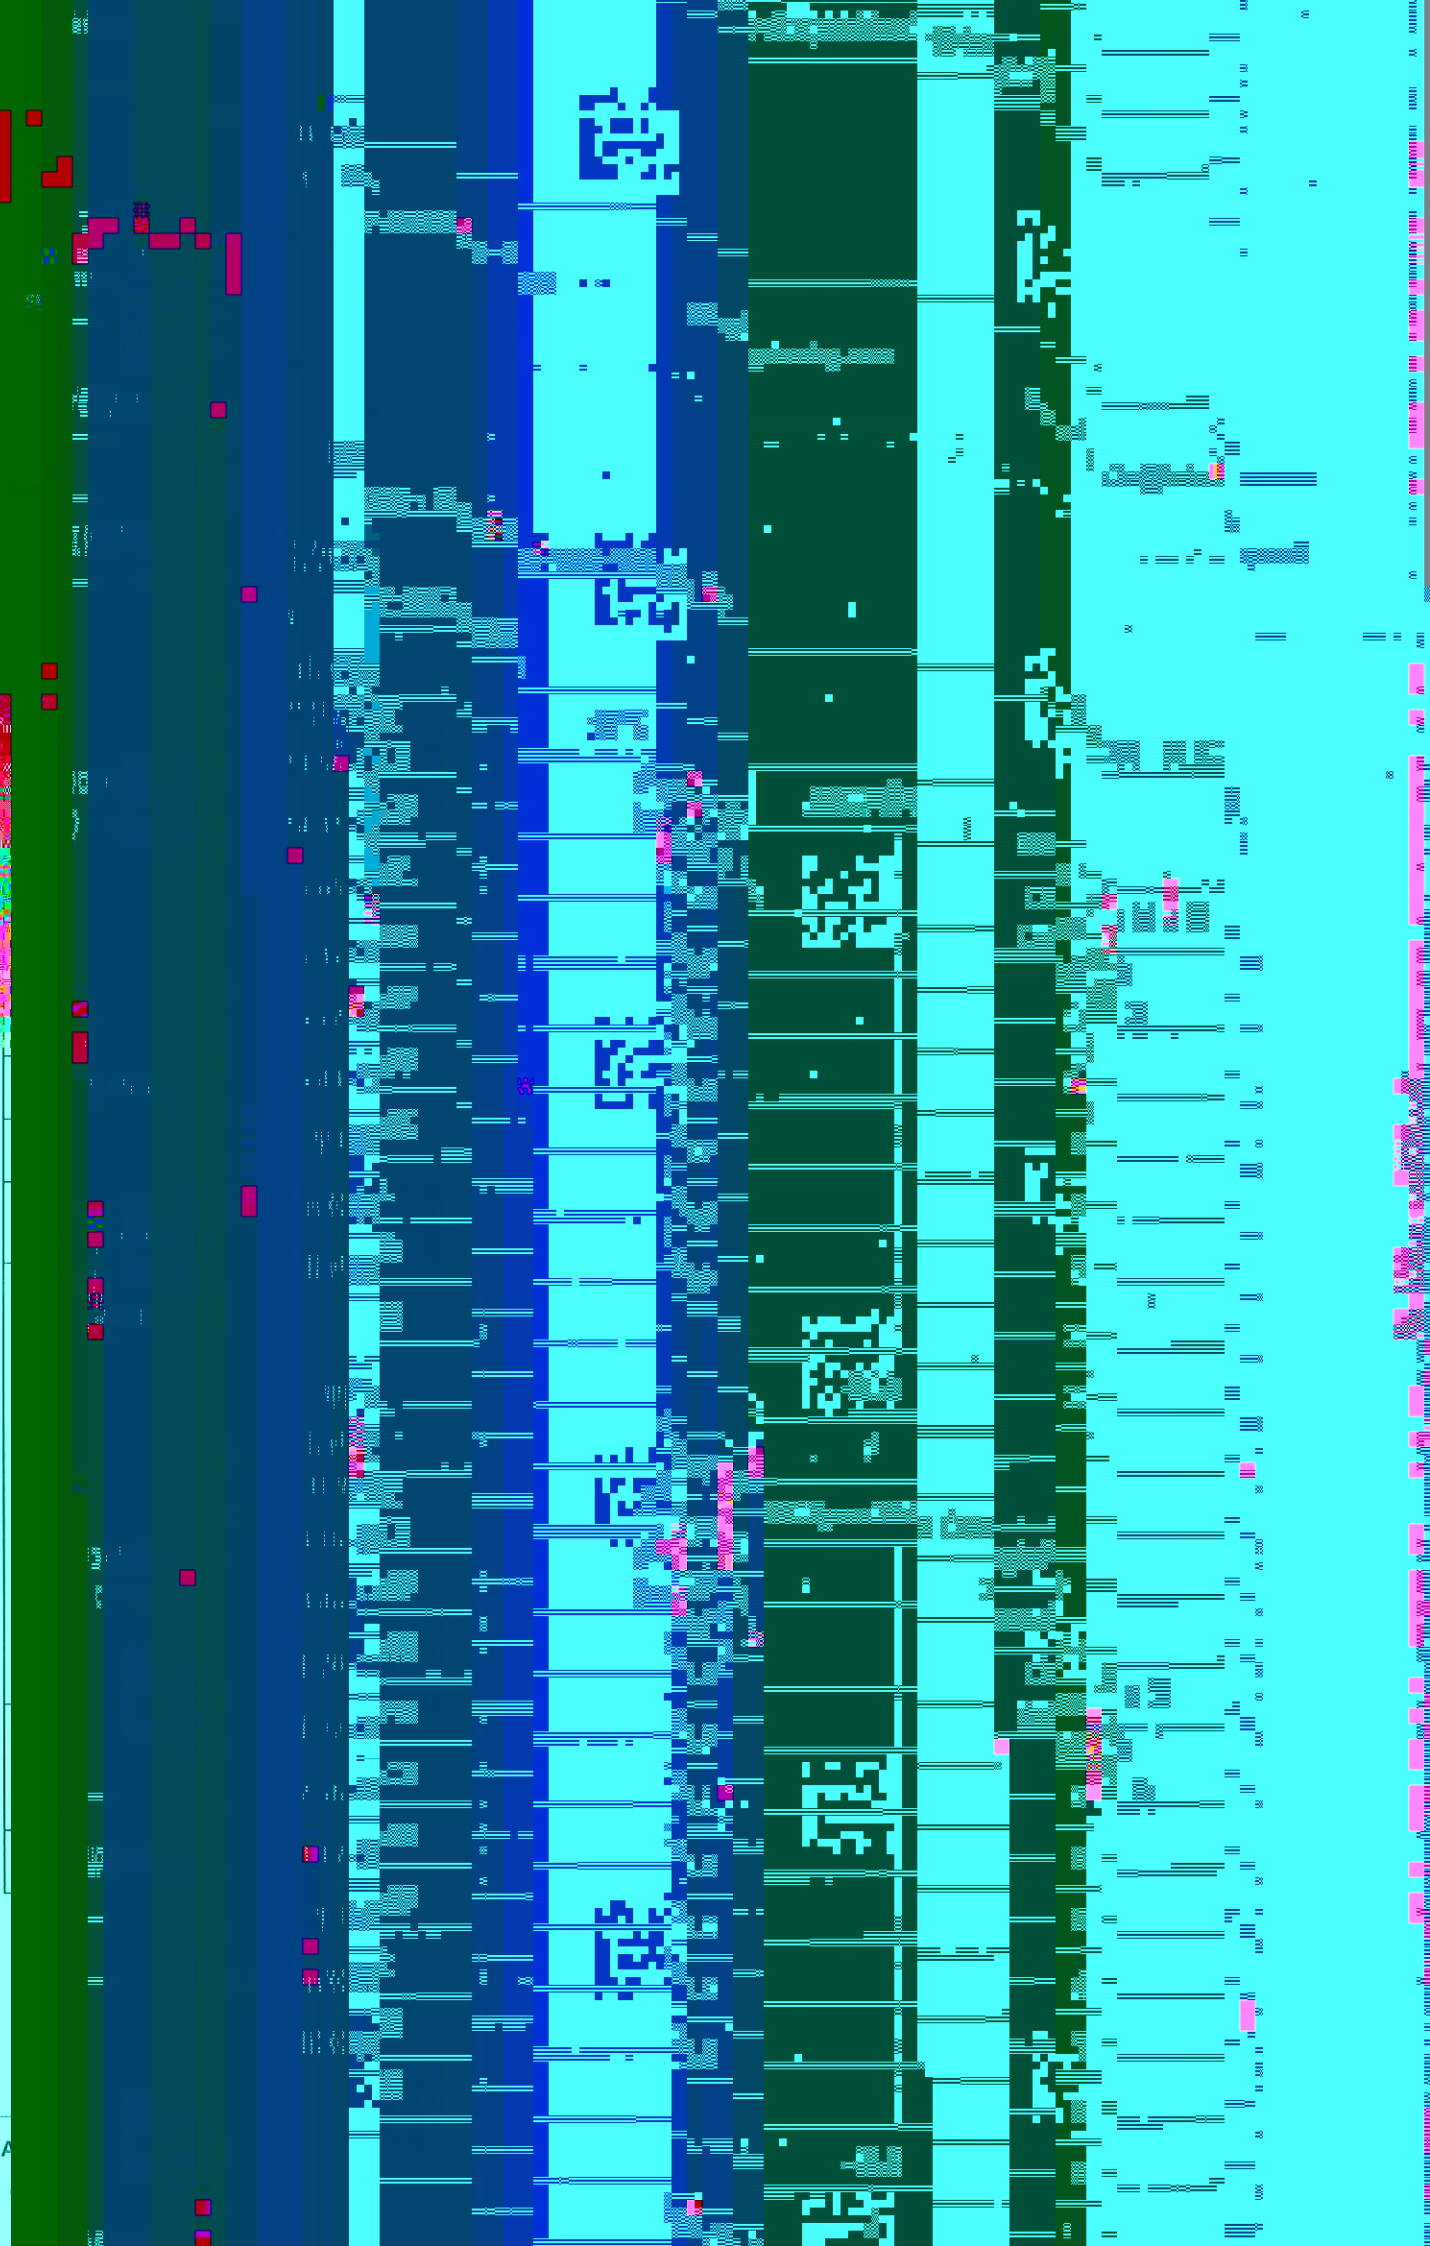

(©1)、DA003(1#排气筒)(©2)污染源自动监测系

编制人: 李静
日期: 2024.4.25

报告结束

N H U ZHENG T
027-87068590
79

华正检测
HU ZHENG TES

九、比对监测结论
监测结果表明: I
系统本次比对监

审核人: 张可成
日期: 2024.4.25

TD.
027-87068590-888

报告编号: 武华委检

002(2#排气筒)
合格。
2024.4.25

张可成

签发人: 张可成
日期: 2024.4.25