
固定污染源烟气排放连续在线监测系统运行比对监测报告

项目名称： 醴陵市生活垃圾焚烧发电项目

HUNAN ENVIRONMENTAL TESTING CO., LTD.

监对监测报告



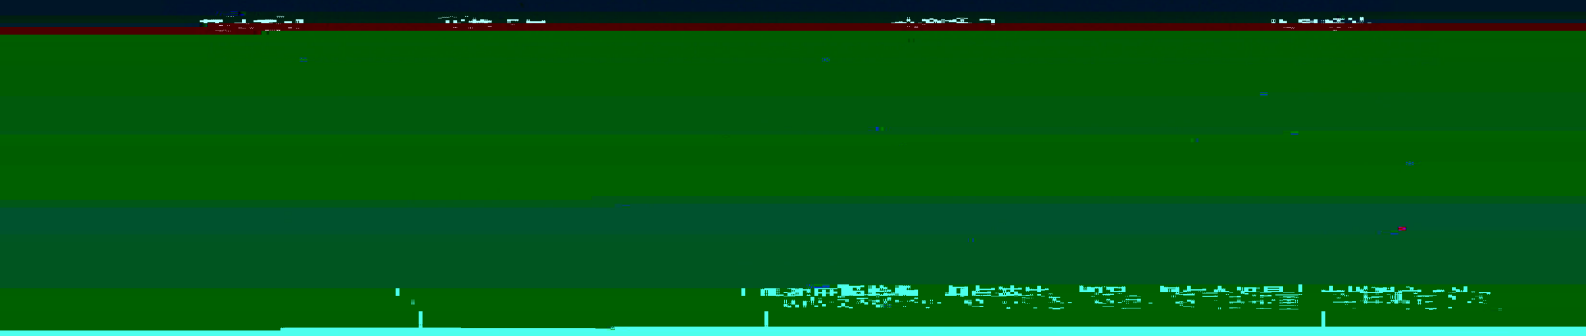

排放浓度<10 mg/m3时，绝对误差为±5 mg/m3

比对监测报告

	相对误差不超过±30%
CEMS	
	低浓度	10μmol/mol（17mg/m³）≤排放浓度<50μmol/mol（82mg/m³）时，

比对监测报告

检测项目	技术要求
	（3750mg/m³）时，绝对误差平均值应在±300μmol/mol（375mg/m³）以内
CEMS 一氧化碳 准确度	50μmol/mol（63mg/m³）<排放浓度≤650
	烟气湿度>5.0%，相对误差不超过±5%
	烟气湿度≤5.0%，绝对误差不超过±1.5%

比对监测报告

表 3-1 实验室分析方法及仪器

氯化氢	量法》HJ 548-2016	50mL、25mL	2mg/m³

六、监测结果

表 6-1 标准气体示值误差

比对监测报告

项目	时间	CEMS	参比方法	准确度	准确度限值	结
			15.15	222.4	206	

设备监测报告

15:10~15:15	8.72	8.1
15:20~15:25	8.13	7.3
15:30~15:35	7.85	7.3
15:40~15:45	8.08	8.0

含氧量（%）：2025.07.09 | 已知浓度液：0.4% | ≥5.0%：指标 | 合格 | 准确度≤1.5%

40.9	18:37~18:57	61.4

监对监测报告

	平均值	1.3	1.0L		
	14:54~15:34	8.22	8.1		

	14:54~15:34	135.2	132.4
	15:44~16:24	133.8	133.1
	16:37~17:17	134.1	133.5